


Gebrauchtgerät

Narkosegerät SULLA 800/808 ohne Ventillog von Dräger

Mit O₂, AIR, und N₂O

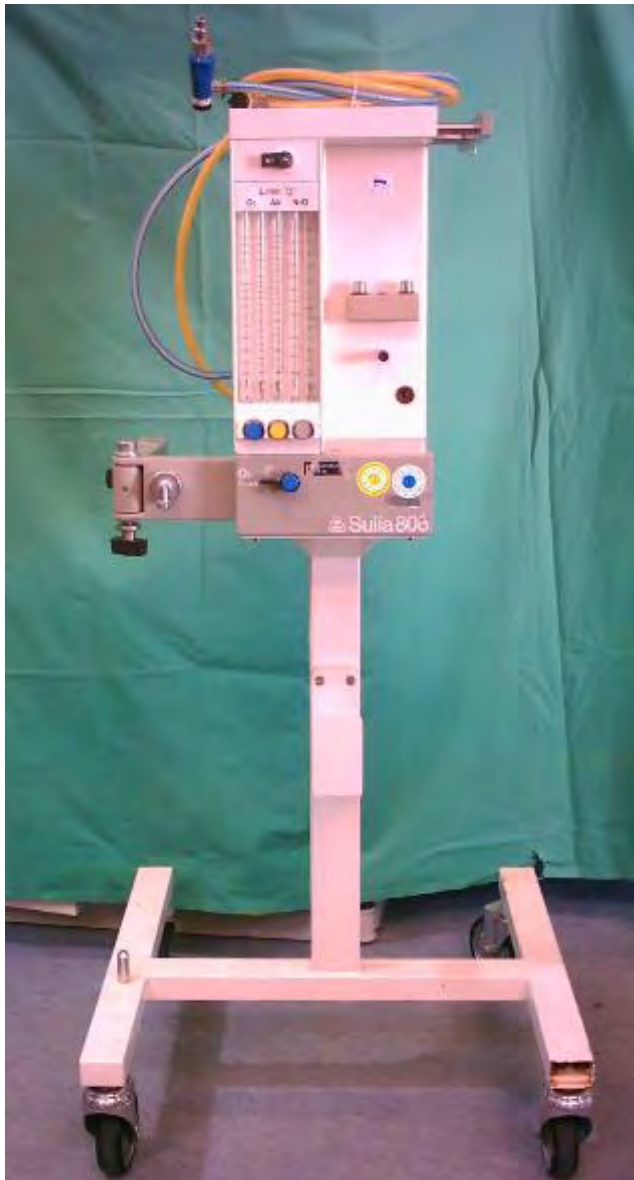

Funktionsprüfung und STK durchgeführt

Kreissystem und Monitoring kann nach Bedarf konfiguriert werden, z.B. CO₂, O₂, Spirometrie, Anästhesiegase.

Umbau des Gerätes auf Flaschenversorgung ist machbar.

Zubehör nach Absprache